

לצדות הרופאי שלך) כדי להפחית את הסיכון של תאונת מגיפות מחלת והעברת מחלות זיהומיות.

ב. השליך את המחת בצורה בטיחותית, לפ' הוראות הצוות הרפואי שלך.

ג. שים תמיד את מכסה העט בחדרה על העט ואיך אחסן את העט עד הדזהה הבאה.

ת朗ع الإبرة دائمًا بعد كل عملية حقن واحفظ سولوستאר بدون إبرة موصولة به.

هذه الإجراءات تساعد على منع:

- إتاحت/أطلقت (contamination).
- دخول هواء لحزام الانسولين وتسرير الانسولين، مما قد يسبب مقدارًا ولوياً غير دقيق.
- الإصابة من الإبرة، لا تأخذ أيديًا غطاء الإبرة الداخلي إلى مكانه.
- إذا تم الحقن من قبل شخص آخر، أو إذا كنت تحقن لشخص آخر على الشخص الذي يحقن أن يوخّل المخبر خاصه عند تشعّع الإبرة والخاص بها. تقدّم بإجراءات الأمان الممدوّنة بها لنزع الإبر والأشخاص منها (نوجة إلى الطاقم الطبي خاصتك) بغية تقليل الخطير لحاد إصابة من إبرة ونقل الأمراض التلوثية.
- ب. تخلص من الإبرة بشكل آمن، وفقاً لتعليمات الطاقم الطبي خاصتك.
- ج. يجب إعادة غطاء القلم دائمًا إلى القلم ومن ثم قم بتخزين القلم حتى موعد الحقن ا

הוראות אחסן
تعليمات التخزين

בדוק בבקשתם של ההוראות כיצד לאחסן את הסולווטאר. אם הסולווטאר שכך מוחסן במקום קרייר, יצא אותו שעה עד שעתים לפניו הדזרקה כדי לאפשר לו להתחכם. איןSoloilן קר מכאייר יותר בהזירה. לאחר גמר השימוש השליך את הסולווטאר שכך בהתאם לדרישות המקוומיים הרגואفحחס التعليمותבفي هذه النشرة حول كففة تخزين سولوستار. في حال حفظ سولوستار خاصتك في مكان بارد، يجب إخراجه ساعة حتى ساعتين قبل وقوع الحقن كي يسخن. فحقن الإنسولين البارد مؤام أكثر. بعد انتهاء الاستعمال إيم الـ سولوستار خاصتك حسب المقتنيان المحلي.

תchap
ה��

הן על הסולויסטאר שלך מփני אבק ולכלוך.
ניתן לנתקות את החלק החיצוני של הסולויסטאר עלי-ידי ניגבו בעדרת מטלית
אין להשרתו, לרוחץ או לשמן את העט מחרור ופעולות אלה יכולות לפגוע בדוחה.
הסולויסטאר שלך מתוכנן לעבוד בצורה מדעית ובוטחה. יש לטפל בו בדוחה
הימנע ממצבים בהם הסולויסטאר עלול להידק. אם אתה חשש שהסולויסטאר
שלך פגום, השתמש בסולויסטאר חדש.
احفظ פلم סולויסטאר خاصةך מן הغياب והאוסואה.
يمكنك تطيف القسم الخارجي لـ سولوستر بواسطة مسحه بقطعة قماش رطبة.
لا يجوز نقع، غسل أو ترتيب القلم لأن هذا قد يلحقضر به.
إن سولوستر خاصةك مصمم ليعمل بدقة وآمان. يجب الاعتناء به بحذر.تجنب الحالات التي
قد يتعرض فيها سولوستر للضرر. إذا كنت تشک بأن إل سولوستر خاصةك معطوباً، استعمل
سولوستر جديد.

שלב 5: הזרק את המנורה المرحلة 5: احقن المقدار

- التأكيد من أن القلم والإبرة بعملان كما يجب
 - إزالة فقاعات الهواء
 - اختيار مقداراً دوائياً من وحدتين بتدوير متبقى المقدار الدوائي.




שלב 4:
المرحلة

- ג. ניחן לכונן את המנה בהפרשים של יוזם
למקסימום של 80 יחידות. אם אתה ד'
לבצע שתי הזרקוטות או יותר.
א. בדוק שהלון המנה מראה "0" לאחר
ב. בחר את הנקה הרצוייה (בגומגה המתו
30 יחידות). אם סובבת מטרב למונטז
בإمكانضبط המقدار הדוائي. בפوارק ذات ווגה
واحدת حتى מינר דואני אופצי דז 80 ווגה
80 ווגה. יbig عليك אجراء הנקה מתרן או
א.تأكد من أن نافذת המقدار הדוائي נטהר 0"
ב. اختاري המقدار הדוائي המطلوب (פע. המנזוז
30 ווגה). إذا كنت ידיור מסתני המقدار
פיקמונת נדרורה לילו ווגה.

הסר את מכסה המחט הפנימי והשלך אותו.
ב. إنزع غطاء الإبرة الخارجي واحفظه لنزع الإبرة المستعملة بعد الحقن. انزع غطاء الإبرة
الداخلي وارمه.

ג. החזק את העט עם המחט כשהם פונים כלפי מעלה.
ד. הקש על מיכל האינסולין כך שבמzdיה יש בעות אויר הן יעלן מעלה לכיוון
החותם.
ה. לחץ על כפתור ההזרקה עד הסוף. בדק אם אינסולין יצא מכתה המחט.
ג. אمسק הפלם עם האברת ביחס לתג'ה נחו האקלם ..

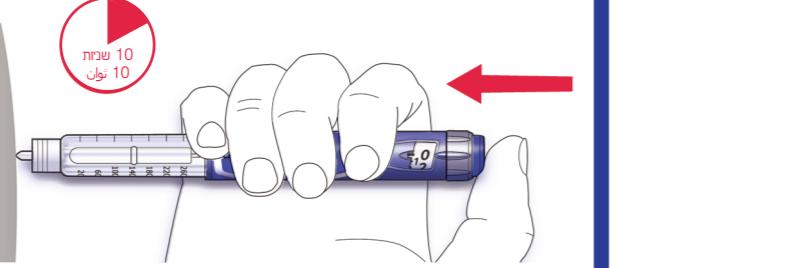

שלב 6: הסר את המחט והשחן المرحلة 6: انزع الإبرة وارمها

שלב 2: חבר
المرحلة 2: أو

- המשמש תמיד תמיד במחט סטרילית חדשה לכל הזרקה. דבר זה לא אפשרות לשימוש המחט.

א. הסר את אטם המגן מחט חדש.

ב. הדקק את המחבט בקו שר עם העט ושמור עליה ישרה בדקחו, תלוי בסוג המחבט).

כעתם דאנמן אירה מעכמתה חדשה לכל عملية حقן. وهذا האمر יסייע על אنسداد האירה.

أ. انزع السداد الواقي عن الإبرة الجديدة.

ب. امسك الإبرة بمواراة القلم وأيقها مستقيمة أثناء وصلها (لولب أو ادفع



• אם המחבט אינו נשמרת בקו שר בזמן החיבור, אטם הגומי ולגרום לדיליפה או לשבירת המחבט.

• إذا لم يتم حفظ الإبرة في وضعية مستقيمة أثناء وصلها، فإن السداد الذي يتضرر وسيسبس التسريب أو كسر الإبرة.

• חבר תמיד מחט חדשה לפני כל שימוש. השתמש רק במקרים המתחייבות לשימוש עם סולוסטאר.

• אל תבחר מנה או תלחץ על כפთור הזרקה אם המחבט לא מוחברת.


• בצע תמיד מבנן בטיחות לפניה כל הזרקה (ראה שלב 3).

• עט זה מיועד לשימוש בלבד בלבד. אל תחלוק אותו עם אדם אחר.

• אם הזרקה מתבצעת על ידי אדם אחר, אדם זה צריך להיזהר במיחוז כדי להימנע מתקירת מהט לא מכונת והעברת זיהום.

• עלולם אל תשמש בסולוסטאר אם פגום או אם אין בטוח שהוא עובד נכון.

 - החזק תמיד בסולוסטאר נוספת נסוך שייה דמין במרקחה של אבידה או נדק לסלוסטאר שכברושות.
 - يجب דאנמןوصל إبرة جديدة قبل كل استعمال. استعمل فقط الإبر المناسب للاستعمال مع سولوسنتر.
 - لا تختار مقبراً دوانياً أو تضغط على زر الحقن إذا لم تكن الإبرة موصولة.
 - يجب دانياً إجراء فحص الأمان قبل كل عملية حقن (أنظر مرحلة 3).
 - هذا القلم متخصص لاستعمالك فقط. لا يجوز مشاطرته مع أي شخص آخر. الوخر غير المقصد من إبرة ونقل تلوث.
 - لا تستعمل سولوسنتر أبداً إذا كان معطوباً أو إذا لم تكن وائقاً بأنه يعمل كما ينبغي.
 - احتفظ دانياً بعلم سولוסنتر إضافي ليكون جاهزاً في حال ضاع أو תضرر سولוסנتر الذي י恨مه.

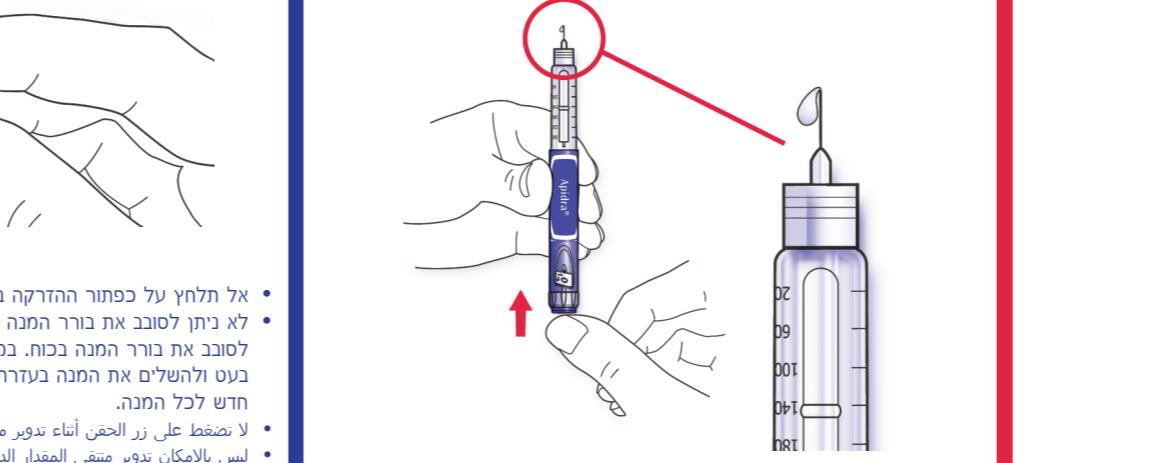

ين يديك. إن

- ب. انزع عطاء الغنم.


ج. افحص مظهر الإنسولين. أيديرا هو إنسولين رائق. لا تستعمل سولوستار الذي يحوزنك إذا كان الإنسولين بداخله عكرًا، ملوثًا أو يحتوي على جزيئات.

ב. בצע תמייד את מבנן הבטיחות לפני כל הזרקה. דבר זה מבהיר
מהירות עליידי:

 - ויזוא שהרט והחמת עובדים כראוי
 - הסרת בועות אויר

א. בחר מנה של 2 יחידות עליידי סיבוב בורר המנה.

قم دائمًا بإجراء اختبار الأعماق قبل كل عملية حقن. فهذا يضمن حصولك على الدقيق وذلك من خلال:

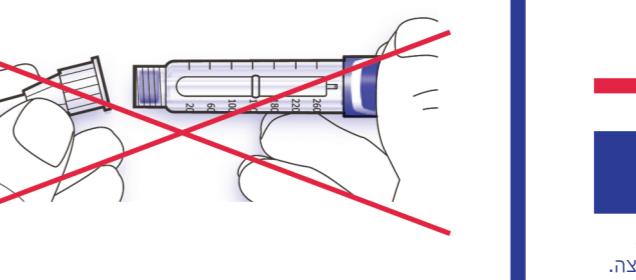

שלב 1: בדוק את האינסולין المرحلة 1: تحقق من الإنسولين

- שלב 3: בצע מבחן בטיחות**

הمرحلة 3: قم بإجراء اختبار الأمان

בצע תמיד את מבחן הבטיחות לפני כל הזרקה. דבר זה מבטיח מודיקת על-ידי:

 - וודוא שהעת והמחט עובדים כראוי
 - הרת ביעות אויר
 - א. בחר מנה של 2 יחידות על-ידי סיבוב בורר המנה.

قم دائمًا بإجراء اختبار الأمان قبل כל عملية حقن. وهذا يضمنحصولك على الدقيق وذلك من خلال:

א. בדוק את התוויות על הסולוסטאר שילק כדי לוודא שבירק האינסולין הנכון.

ב. הסר את מכסה העט.

ג. בדוק את מראה האינסולין. אפיידרה היא אינסולין צלול, אל תשתמש בסולוסטאר שברשותך אם האינסולין שבתוכו עכוו, צבע או מכל חלקיים.

ה. אفحص המלכשה עלி לא סולוסטארخاصistikתläkden من وجود الإنسולין الصحيح بين يديك. إن أيديرا سولוסטאר هو أزرق اللون مع زر حقن أزرق وحلقة بارزة في الطرف.

ب. انزع غطاء القلم.

ג. אفحص מטهر האינסולין. איפירה הוא אינסולין רائق. לא تستعمل סולוסטאר الذي בحوزتك إذا كان האינסולין بداخله עקרן, מלוּא או יحتוּי על גזיות.